



ATHENA C18 120A Column Application Note:

Antioksidant lar için HPLC ile çalışmalar yapılmıştır. Klasik C18 Fazlar ile çoklu antioksidant kromatografik ayrımları başarılı olmamıştır. Bu sebeple Athena C18 120A fazlı kolonun performansı başarılı olmuştur.

ATHENA C18 120A 150x4.6mm, 5µm Column



VDS SPHER PURE C18-SE 150x4.6mm, 5µm Column

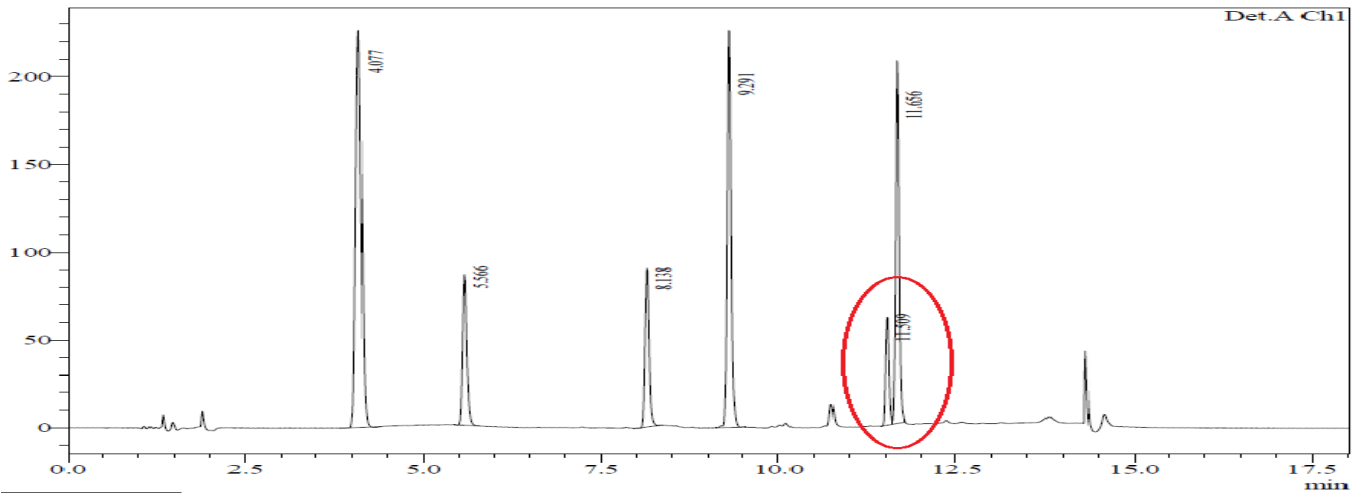

3 Farklı kolon kıyaslama sonuçları

